


Silla de Ruedas Bipedestadora

MANUAL DEL PROPIETARIO

setonix




Estructura

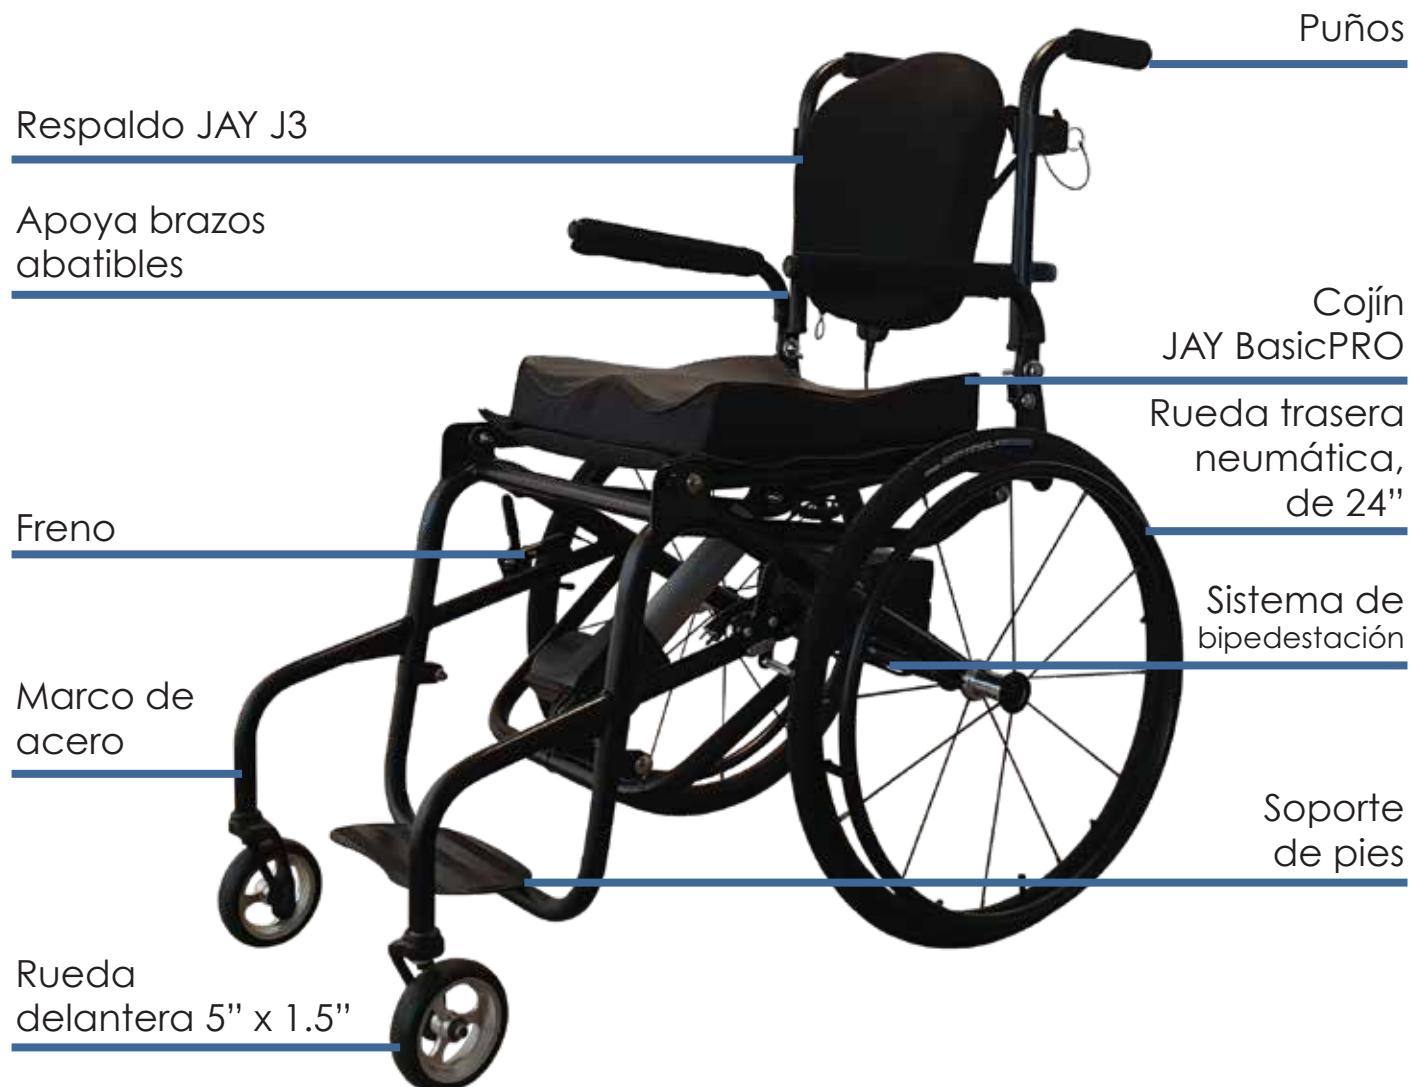

Capacidad: 120 kg
(máximo peso del usuario)

Peso Total: 25 kg
(con batería)

Especificaciones

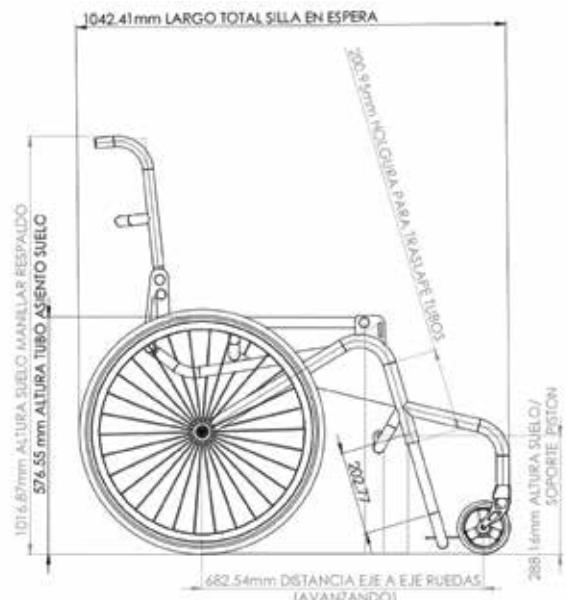

Uso

Uso de los frenos

Sostenga las manijas de los frenos con ambas manos mientras la silla de ruedas Setonix está detenida. Lleve las manijas de los frenos hacia adelante hasta su posición de auto-bloqueo para evitar que las ruedas traseras se muevan. (fig.1).



fig. 1

Sistema de

Bipedestación:	Eléctrico
Estructura:	Acero
Ruedas posteriores:	Neumática 24"
Ruedas anteriores:	5" x 1.5"
Peso total:	25 kg
Duración de la batería:	7 días aprox.
Largo total:	104 cm
Ancho total:	66 cm
Ancho asiento:	48 cm
Profundidad asiento:	45 cm
Peso de llevante:	120 kg
Voltaje:	120v
Batería:	Acido IP54
Tiempo de carga:	8 horas

El uso del Cinturón de Rodilla

Ambos cinturones, tanto como el de las rodillas, así como el del pecho, deben asegurarse bien antes de activar la posición de pararse de su Silla Setonix. Para asegurar el cinturón de las rodillas, simplemente coloque el cinturón debajo de sus rodillas, con el separador en medio de las rodillas. Fije el clip circular en cada extremo del cinturón de las rodillas al anclaje circular que está a cada lado del marco. Use la correa de velcro para ajustar y apretar el cinturón de las rodillas para que sus piernas queden aseguradas. El uso inadecuado del cinturón de las rodillas puede causarle lesiones o incluso la muerte.

Uso (continuación)

El uso del Cinturón de Pecho

Ambos cinturones, tanto como el de las rodillas, así como el del pecho, deben asegurarse bien antes de activar la posición de pararse de su Silla Setonix. Para asegurar el cinturón de pecho, coloque el cinturón alrededor de su pecho y de ambos bastones traseros de la silla. Conecte los clips plásticos y hale las correas para ajustar y apretar el cinturón contra su cuerpo. El uso inadecuado del cinturón de pecho puede causarle lesiones o incluso la muerte.

Posición para Ponerse de Pie

Para ponerse de pie en su Silla Setonix, asegúrese que esté sobre una superficie plana. Siempre asegúrese de tener sus cinturones de pecho y de rodillas correctamente asegurados. Comience por activar los frenos para evitar rodar mientras esté en posición de pie. Cuando ya estén activados los frenos, presione la flecha "up" o "arriba" que se encuentra en el control manual (fig. 2). La Silla comenzará a levantarse suavemente hasta llegar por completo a la posición de estar de pie.

Regresar a la Posición de Sentarse

Para regresar a la posición de sentarse, presione la flecha "down" o "abajo" en el control manual hasta que la silla haya regresado completamente a su posición para sentarse. (fig. 2). Ya en la posición de sentado puede liberar los frenos y volver a desplazarse.

El uso de los Apoya-Brazos Abatibles

Los apoya-brazos abatibles de su Silla Setonix pueden moverse hacia atrás para que sea más fácil salir o entrar a su Silla. Estos apoya-brazos le dan estabilidad y seguridad cuando está en posición de pararse. Para retraer los apoya-brazos, simplemente empújelos hacia arriba hasta que se doblen por completo hacia atrás (fig. 3). Empújelos hacia adelante nuevamente para regresarlos a su posición original.



fig. 2



fig. 3

Seguridad

Advertencia

La Silla Setonix con posición para ponerse de pie, probablemente no es para todas las personas. En ciertos casos la posición de pararse, puede causar complicaciones a futuro. Algunos de estos casos incuye a usuarios con fracturas en miembros inferiores, con osteoporosis avanzada, con problemas de rigidez en articulaciones, etc. Por favor consulte a su médico antes de utilizar su Silla Setonix con posición para ponerse de pie.

NO se levante al máximo de la altura demasiado rápido. Hágalo pausadamente en intervalos hasta que su tolerancia incremente. Si siente mareos o siente cansancio, baje hasta llegar a la posición completa de sentado y tómese su tiempo para recuperarse. En sus primeras semanas posiblemente no aguante mucho tiempo en la posición de pie, pero con el pasar de los días, va a poder estar en la posición de parado por más tiempo.

NO introduzca las manos ni cualquier objeto en el mecanismo de la Silla Setonix.

Estabilidad de la Silla

La Silla Setonix está diseñada para proporcionar seguridad y estabilidad mientras se está sentado en ella, siempre y cuando se mantenga su centro de gravedad al utilizarla normalmente en cualquier actividad. Siempre debe de tener precaución mientras haga cualquier actividad que comprometa su centro de gravedad en la Silla. Nunca trate de alcanzar más de lo necesario levantándose un poco de la Silla ni doblando su cuerpo fuera de ella. Cuando usted trata de alcanzar objetos que lo obligan a inclinarse hacia adelante, asegúrese que las ruedas delanteras estén apuntando hacia adelante, de esta manera extenderá un poco más el área de la base y a su vez incrementará la estabilidad de la Silla.

Estabilidad en Posición de Pie

La Silla Setonix está diseñada para ser segura y estable cuando se utiliza en la posición de pie, siempre y cuando se mantenga el centro de gravedad mientras se utiliza en esta posición. Siempre asegúrese

Seguridad (continuación)

de activar ambos frenos antes de activar la posición de ponerse de pie y nunca intente desplazarse en esta posición. Nunca active el ponerse de pie en ningún tipo de desnivel. Solamente en superficies completamente horizontales.

Rampas

Esté seguro de sus propias capacidades, limitaciones y fuerza antes de intentar subir una rampa. La técnica correcta para deslizarse sobre una rampa debe enseñársela un profesional calificado. Si usted debe detenerse en una posición inclinada, evite los movimientos repentinos y abruptos al ponerse nuevamente en movimiento. Una angulación hacia atrás de la silla o un movimiento repentino y abrupto podrían causar inestabilidad. Intentar usar los frenos de bloqueo de rueda podría resultar en una frenada repentina con bloqueo accidental, haciendo que la silla se incline hacia un lado. Evite cambiar de dirección mientras desciende una pendiente, ya que esto podría provocar inestabilidad o incluso el vuelco. Nunca use su silla de ruedas Setonix en una pendiente de más de 4,8° de inclinación.

Ciudad de la Silla

Siempre asegúrese de que su silla Setonix quede seca luego de ser usada para prevenir la corrosión. Debe ser lavada de forma regular con agua tibia y detergente neutro. Séquela después de lavarla.

Garantía

Loh Medical ofrece una garantía de 6 meses sobre la Setonix. Cualquier componente defectuoso será reemplazado sin costo alguno. Por favor, contáctese con su representante local de ventas de Loh Medical por los servicios relacionados con la garantía. Para más información acerca de su representante local de ventas de Loh Medical, visite:

www.lohmedical.com/contact/contact-form